

Produktprüfung MNS 03 nach DIN EN 14683

Gemäß den Untersuchungen durch die Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG bestätigen wir das Bestehen folgender Prüfungen:

- Bakterielle Filterleistung: $\geq 98\%$
- Druckdifferenz: $< 40 \text{ Pa/cm}^2$
- Mikrobiologische Reinheit: $\leq 30 \text{ KBE/g}$


Die Prüfung zur Biokompatibilität zeigt, dass aus dem Prüfgegenstand keine zelltoxischen Substanzen freigesetzt wurden.

Die überprüften Proben entsprechen den Vorgaben der DIN EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken des Typs II.

Münster, 17. Juni 2020



Christopher Heine
CEO

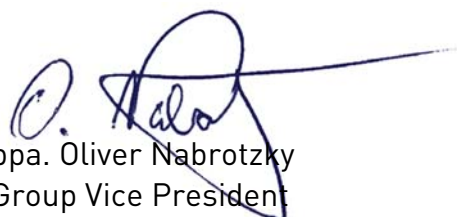

ppa. Oliver Nabrotzky
Group Vice President